PROTOCOLE D'UTILISATION

INSTRUMENTS

AVANT DE COMMENCER

Mettre des gants appropriés.
Porter un appareil de protection des yeux et du visage.
Nettoyer et rincer très soigneusement tout instrument avant le trempage dans Stéranios 2 %.

MODE D'EMPLOI

Ne pas diluer.
Produit prêt à l'emploi.
Temps de trempage : 20 mn (1 h pour obtenir l'activité sporicide).

ATTENTION

- Produit nocif.
- Précautions d'emploi : se référer à la fiche de données de sécurité et à l'étiquette. Produit classé selon la Directive Européenne "Préparations dangereuses" 1999/45/CE.
- Ne pas mélanger avec d'autres produits chimiques (détergents, savons…).
- Ne pas laisser tremper les instruments plus d'une heure.

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES

- **Bactéricide** (NF EN 1040, NF T 72-171, NF T 72-190, T 72-301).
- **Actif sur BK.**
- **Fongicide** (NF EN 1275, NF T 72-190).
- **Sporicide** (NF T 72-230/231, T 72-301).
- **Virucide** (NF T 72-180).
- **Actif sur les virus** HIV-1, Herpès et Hépatite B.

Laboratoires ANIOS 05a-0382FR

Stéranios 2 %

Stéranios 2 % est recommandé pour la désinfection totale à froid des instruments thermosensibles, des dispositifs médicaux non autoclavables et du matériel d'endoscopie. La désinfection de haut niveau avec Stéranios 2 % n'intervient qu'après un nettoyage et une pré-désinfection soignés.

CE 0459

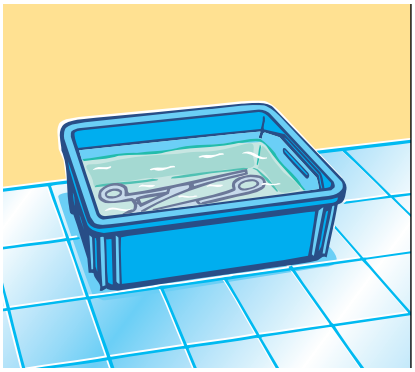

1 Au préalable, nettoyez le matériel avec Hexanios G+R, Aniosyme PLA, Aniosyme 3000 ou Salvanios pH 10…

2 Rincez soigneusement sous eau courante.

3 Stéranios 2 % est prêt à l'emploi. Versez-le dans un instrubac. Immergez les instruments.

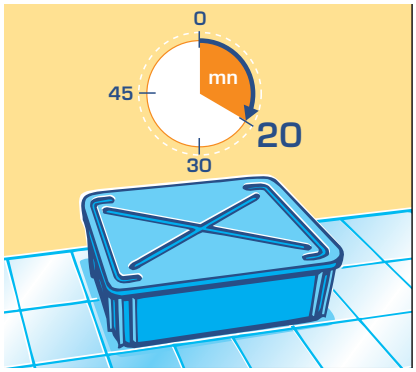

4 Couvrez le bain de trempage et laissez Stéranios 2 % en contact pendant 20 minutes (1 heure pour les formes sporulées).

5 Rincez très soigneusement à l'eau filtrée sur 0,2 µm dans un instrubac désinfecté pour le matériel ne devant pas être obligatoirement stérilisé.

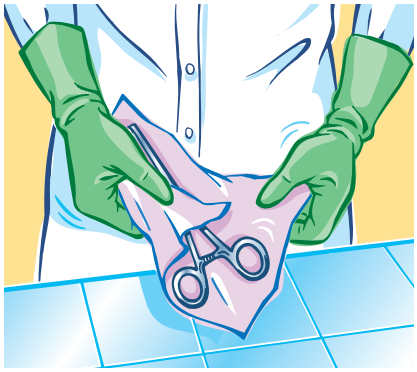

6 Essuyez avec un champ stérile.

Fisher Bioblock Scientific
Parc d'innovation - BP 50111 - F67403 illkirch cedex

France
tél 03 88 67 14 14
fax 03 88 67 11 68
email vente@bioblock.fr
www.bioblock.com

Belgique / België
tél 056 260 260
fax 056 260 270
email belgium@bioblock.com
www.bioblock.be

España
tfno 91 515 92 34
fax 91 515 92 35
email ventas@bioblock.com
www.es.fishersci.com

AFAQ ISO 9001 AFAQ N1995/37236
CERTIFIED EQNet QUALITY SYSTEM